*Matavimo laiko rodymo metodai;

1) Matavimai atlikti prieš 600 minučių ir mažiau bus rodomi “-praėjęs laikas“.
Pavyzdys: Matuota prieš 1 minutę -> -001
Matuota prieš 23 minutes -> -023
Matuota prieš 523 minutes -> -523

2) Matavimas atliktas prieš nuo 601 minutės iki 1 dienos bus rodoma kaip "d000".
Pavyzdys: Matuota prieš nuo 601 minutės iki 1 dienos -> d000

3) Matavimas atliktas prieš nuo 1 dienos iki 999 dienų bus rodoma kaip "d + praėję dienų".
Pavyzdys: Matuota prieš 1 dieną -> d001
Matuota prieš 23 dieną -> d023
Matuota prieš 523 dieną -> d523

Kitas bandymo rezultatas su matavimo laiku bus rodomas nuosekliai paspaudus [M] atminties mygtuką. Alkotesteris atkurs iki 10 bandymų rezultatų su matavimo laiku. Jei atmintis pilna, seniausias bandymo rezultatas, įskaitant matavimo laiką, bus ištrintas automatiškai.

Rodomi pranešimai ir gedimo šalinimo vadovas

Pranešimas	Reikšmė	Sprendimas
LO BAT	Pilna baterijos talpa	Pilna baterija

LO BAT	Pranešama, jog baterijos išsikrovė. Įrenginį galima naudoti, tačiau norint gauti teisingą rezultatą, reikia įdėti naujas baterijas.	Pakeisti baterijas į naujas.
BAt	Jei LCD ekrane rodoma „BAt“, įrenginys negali veikti.	Skubiai pakeisti baterijas į naujas.
FLo	Kai bandymui neužtenka mėginio tūrio ar pūtimo galios.	Paspauskite ⏻ mygtuką kad pakartotumėte matavimą.
0.0b	Jei per 30 sekundžių nėra paimamas iškvėpimo mėginys, LCD ekrane bus rodoma „OUT“.	Paspauskite ⏻ mygtuką, kad pakartotumėte skaičiavimą ir matavimą
0.0t	Rodoma klaida, kai veikimo temperatūra nėra pateiktame veikimo diapazone.	Įrenginiui pasiekus reikiamą darbinį temperatūros diapazoną pakartoti bandymą.
Err2	Įrenginiui rodant 'Err2' klaidą po 5 žingsnio - pūtimo metu pateko per daug seilių.	Pakartoti bandymą po 20 minučių.
500	Atlikus daugiau nei 500 pūtimo bandymų reikalingas įrenginio kalibravimas	Norėdami gauti tinkamą kalibravimo paslaugą, susisiekite su vietiniu platintoju.
CAL	Įrenginiui rodant 'CAL' klaidą - įrenginys naudojamas daugiau nei 365 dienas nuo paskutinio įrenginio kalibravimo.	Norėdami gauti tinkamą kalibravimo paslaugą, susisiekite su vietiniu platintoju.

d365	Likusios dienos iki įrenginio kalibravimo, pvz., d365 reiškia, jog liko 365 dienos.	Norėdami gauti tinkamą kalibravimo paslaugą, susisiekite su vietiniu platintoju.
d001	Praėjusios dienos nuo reikiamos kalibravimo datos, primenanti atlikti kalibravimą. pvz. d.001 reiškia 1 dieną nuo reikiamos perkalibravimo datos.	Norėdami gauti tinkamą kalibravimo paslaugą, susisiekite su vietiniu platintoju.

Techninės specifikacijos

Alkoholio kiekio kraujyje (BAC) indikacija	0.000 ~ 0.500%BAC 0.00 ~ 5.00‰ 0.00 ~ 2.50mg/l
Tikslumas	+/- 0.005%BAC at 0.1%BAC at 25˚C +/- 0.05‰ at 1.0‰ at 25˚C +/- 0.025mg/l at 0.50mg/l at 25˚C
Pasiruošimo laikas	Per 15 sekundes prie 0.50 g/l(‰) Pasiruošimo laikas gali skirtis, atsižvelgiant į išmatuotą BAC.
Jutiklio tipas	Elektrocheminis elementas
Maitinimo šaltinis	2 x AAA dydžio šarminės baterijos
Baterijos gyvavimas	Maždaug 1000 bandymų
Matmenys(PxAxG)	47mm x 108mm x 17mm
Svoris	85g su baterijomis
Kalibravimas	Kas 12 mėn. arba po 500 bandymų
Veikimo temperatūra	5 ~ 40˚C

Dėl funkcinių patobulinimų specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Garantija

Gamintojas užtikrina, jog gaminys pagamintas be jokių gamybos ar medžiagų defektų (išskyrus kalibravimą) ir skiria prietaisui 1 (vienerių) metų nuo pirkimo datos arba 500 iškvėpimo bandymo testų garantiją, atsižvelgiant į tai, kad įvyks anksčiau. Gamintojo įsipareigojimas pagal šią garantiją apsiriboja įrenginio pakeitimu, pritaikymu ar taisymu gamintojo pasirinkimu, jeigu įrenginys yra gražinamas su pirkimo įrodymu.
Už bet kokius defektus, atsiradusius dėl stichinės nelaimės ar kliento aplaidumo, netinkamo naudojimo, ardymo ir taisymo, kurį atliko neįgaliotas asmuo, už remonto ar dalies keitimo išlaidas turi būti mokamos pagrįstos išlaidos.

Klientų aptarnavimas

Jei turite klausimų ar siekiate popardaviminio aptarnavimo, produkto kalibravimo ar norite nusipirkti papildomų kandiklių, prašome susisiekti su artimiausiu platintoju ar pardavėju.

Platintojas:

Dignita®

Dignita Alkotesteris

Su aukšto tikslumo elektrocheminiu elemento jutikliu

AM-7000

Naudotojo Instrukcija

-10 paskutinių matavimų išsaugojimas atmintyje
-Elektrocheminis elementas
-Skaitmeninis ekranas su 4 simboliais
-Greitas atsakymo laikas
-Automatinis išsijungimas

Svarbi saugos informacija

- Prieš naudodamiesi alkotesteriu, atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir atlikite matavimą.
- Rekomenduojama naudoti kalibravimo paslaugą kas 12 mėnesių arba po 500 bandymų. Naudojant be periodinio kalibravimo paslaugos, rezultatas gali būti neteisingas.
- Matavimas turėtų būti atliktas praėjus 30 minučių po valgio, gėrimo ar rūkymo. Nelaukus 30 minučių, rezultatai gali būti neteisingi.
- Alkoholio likučiai burnoje gali iškraipyti matavimą.
- Nenardinkite įrenginio į vandenį.
- Aromatiniai gėrimai ar burnos purškalai, kuriuose yra alkoholio, gali iškreipti rezultatus. Tokiu atveju palaukite 30 minučių arba praskalaukite burną grynu vandeniu.
- Nepūskite į alkotesterį cigarečių dūmų - jie gali sugadinti jutiklį.
- Negalima vairuoti išgėrus. Net nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti įprastam vairavimui.
- Nenaudokite šio prietaiso kaip įrankio nustatyti girtumą ir tęsti vairavimą.
Gamintojas ir pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės už alkotesterio rezultatus.
- Nenaudojant įrenginio ilgą laiką, laikykite jį su išimtomis baterijomis.
Jei bandymas atliekamas po ilgo įrenginio nenaudojimo, pirmojo bandymo rezultatai gali būti netikslūs.

- Pakeiskite baterijas, kai baterijos indikatoriaus piktograma pasidaro tuščia.
- Jei bandymo rezultatas yra didesnis nei 0,1% BAC (1,0 g / l) ir bus atliekama daugiau bandymų be pertraukų, įrenginio pasiruošimo laikas gali būti ilgesnis.
- Atlikite bandymus įrenginio darbinėje temperatūroje, nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Stipriu pūtimo metu seilės gali patekti į jutiklį ir sugadinti jį.
- Nelaikykite prietaiso ten, kur yra aukšta temperatūra ar (ir) drėgmė.
- Turėtų būti laikomas vaikams iki 12 metų nepasiekiamoje vietoje

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote ypač patikimą asmeninio naudojimo alkotesterį Dignita AM-7000. Alkotesteris gali būti naudojamas ligoninėse, mokyklose ir daugelyje kitų pramonės sričių. Naudojant ypač patvarų ir tikslų elektrocheminį elemento jutiklį, nustatomas numatomas BAC (alkoholio kiekis kraujyje) pro žmogaus iškvėptą orą.

Turinys

- Skaitmeninis alkotesteris Dignita AM-7000
- 2 x AAA baterijos
- 6 x alkotesterio kandikliai
- Dėklas
- Naudotojo Instrukcija

Dalių pavadinimai

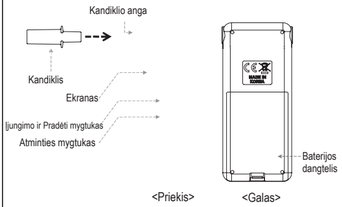

Pasiruošimas

Įdėkite dvi AAA baterijas į baterijų skyrių, atkreipdami dėmesį į nurodytus baterijų poliškumus.

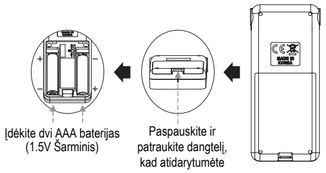

Įkiškite kandiklį į angą alkotesterio šone.

Įsitikinkite, jog kandiklis įkištas tvirtai ir saugiai. Papildomi kandikliai turėtų būti naudojami dėl sanitarinių priežasčių atliekant kito asmens bandymus.

Matavimo atlikimas

1 žingsnis: Paspauskite [⏻] įjungimo mygtuką. Ekrane bus rodomas bendras atliktų bandymų skaičius

2 žingsnis: Likusios dienos iki kalibravimo bus rodomos po bandymų skaičiaus. Atgaliniui dienų skaičiavimui pasiekus 0 dienų, bus rodomas užrašas „CAL“ ir mirksės mėlyni diodai.

3 žingsnis: Atgalinis skaičiavimas bus pradėtas automatiškai - likus 2 sekundėm giliai įkvėpkite.

4 žingsnis: Atgaliniui skaičiavimui pasiekus 0 ir du kartus supypsėjus bus rodomi trys brūkšniai [⏻] ir pasirodys užrašas "START". Pūskite pro kandiklį penkias sekundes, kol pasigirs dvigubas pyptelėjimas.

5 žingsnis: Kai mėginių ėmimas bus sėkmingas, LCD išorinės linijos pasisuks išilgai LCD krašto, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

6 žingsnis: Apskaičiuotas BAC (alkoholio koncentracija kraujyje) bus rodoma po kelių sekundžių (priklausomai nuo alkoholio lygio) ir bus rodomi dar keltą sekundžių. Norint matuotis dar kartą, paspauskite mygtuką [⏻], kad paleistumėte iš naujo skaičiavimo ciklą.

Alkotesteris išsijungia automatiškai praėjus 15~20 sekundžių po 6 žingsnio.

Priverstinai išjungti galima atliekant 3 ir 4 žingsnius. Paspaudus ir palaikius 2~3 sekundes mygtuką [⏻] išjungsite alkotesterį.

Atminties režimas

*Alkotesteris atkurs iki 10 paskutinių bandymo rezultatų su matavimo laikais.

Norėdami pereiti į atminties režimą, prasidėjus atgaliniam skaičiavimui (3 žingsnis) paspauskite mygtuką [M].
Naujausias bandymo rezultatas bus rodomas kartu su matavimo laiku - matavimo laikas pirmiausia bus rodomas trimis žemiau pateiktais rodymo būdais, o tada bandymo rezultatas pasirodys iškart po matavimo laiko.

FRONT

AM-7000

Dignita®

BACK

Dignita®